Basko
Healthcare

Bestelformulier voor maatwerk COS-Swing Phase Lock 2 orthese

Contactinformatie

Firma: _____ Telefoon: _____
Contactpersoon: _____ Telefax: _____
Straat: _____ E-mail: _____
Postcode: _____ Plaats: _____ Klant. nr.: _____

Patiëntinformatie

Identificatienummer: _____ Geslacht: ❍ Man ❍ Vrouw
Diagnose: _____ Betroffen zijde: ❍ Links ❍ Rechts
Gewicht: _____ kg Lengte: _____ cm Leeftijd: _____
Activiteitenniveau: ❍ Laag ❍ Gemiddeld ❍ Hoog Gebruik steunzolen: ❍ Ja ❍ Nee

Voorwaarden maatname

1. Het gipsnegatief moet uit kunststofgips gemaakt zijn.
2. Gipsen onder gelijkmatige belasting (bdz.) in neutrale positie met de voet in 90° en de belastingslijn loodrecht door heup, knie en enkel.
3. Het gipsnegatief is overal stevig genoeg (2 à 3 lagen) met daarop het ID-nummer van de patiënt genoteerd.
4. Indien de patiënt gebruik maakt van steunzolen dan dienen deze gedragen te worden tijdens de maatname.
5. Het gipsnegatief moet na het gipsen gesloten worden om de gewenste vorm te behouden.
6. De mechanische knie-as moet gemarkeerd zijn en worden doorgeprikt volgens de Nietert methode (19mm ± 0.15mm hoger dan de gewrichtsspleet). Let op: assen doorprikken met een dunne priem is voldoende.
7. De mechanische enkel-as moet ook gemarkeerd zijn en worden doorgeprikt met een dunne priem.
8. Standaard wordt de satelliet op broekzakhoogte gemonteerd indien anders gewenst dit aangeven op het gips.
9. Maak een contourtekening van de binnenzool van de schoen.

NOTE: Controleer of alle gevraagde velden zijn ingevuld op het formulier en stuur deze mee met het gips. Neem bij onduidelijkheden of voor assistentie bij de maatname contact op met Basko Healthcare.

GIPSNEGATIEVEN DIE NIET AAN BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN VOLDOEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

(Pasvorm)garantie

Vanaf de datum van aflevering biedt Basko Healthcare 1 jaar garantie op een COS-SPL 2 maatwerkorthese en een pasvormgarantie van 3 weken. Deze pasvormgarantie geldt alleen indien maatname plaatsvindt op een vormvast been. Ieder jaar dient er verplicht onderhoud uitgevoerd te worden middels een Refurbish Kit voor SPL2: # IQ200-RK; DA enkelscharnier: # 020886-RK en indien van toepassing een SPC Refurbish Kit # IQ120RK. De orthese wordt uit Prepreg geproduceerd. Prepreg is een zeer rigide maar licht materiaal (carbon) wat niet thermoplastisch vervormbaar is. Daarom zijn thermoplastische modificaties achteraf niet mogelijk.

Correcties gipsnegatief

❍ Geen correcties uitvoeren ❍ Onderstaande correcties uitvoeren

Knie:		Enkel		Voet	
❍ Varus	+ _____°	❍ Dorsaalflexie	+ _____°	❍ Endorotatie	+ _____ °
❍ Valgus	+ _____°	❍ Plantairflexie	+ _____°	❍ Exorotatie	+ _____ °
❍ Flexie	+ _____°			❍ Varus	+ _____ °
❍ Extensie	+ _____°			❍ Valgus	+ _____ °

Opmerkingen:

_____
_____
_____

Basko Healthcare
Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail: verkoop@basko.com
basko.com

Maatvoering been

Pat. ID-nummer: _____

□ Hoogte ○ Omvang △ Breedte M-L

Maten gelieve in **millimeters** te noteren

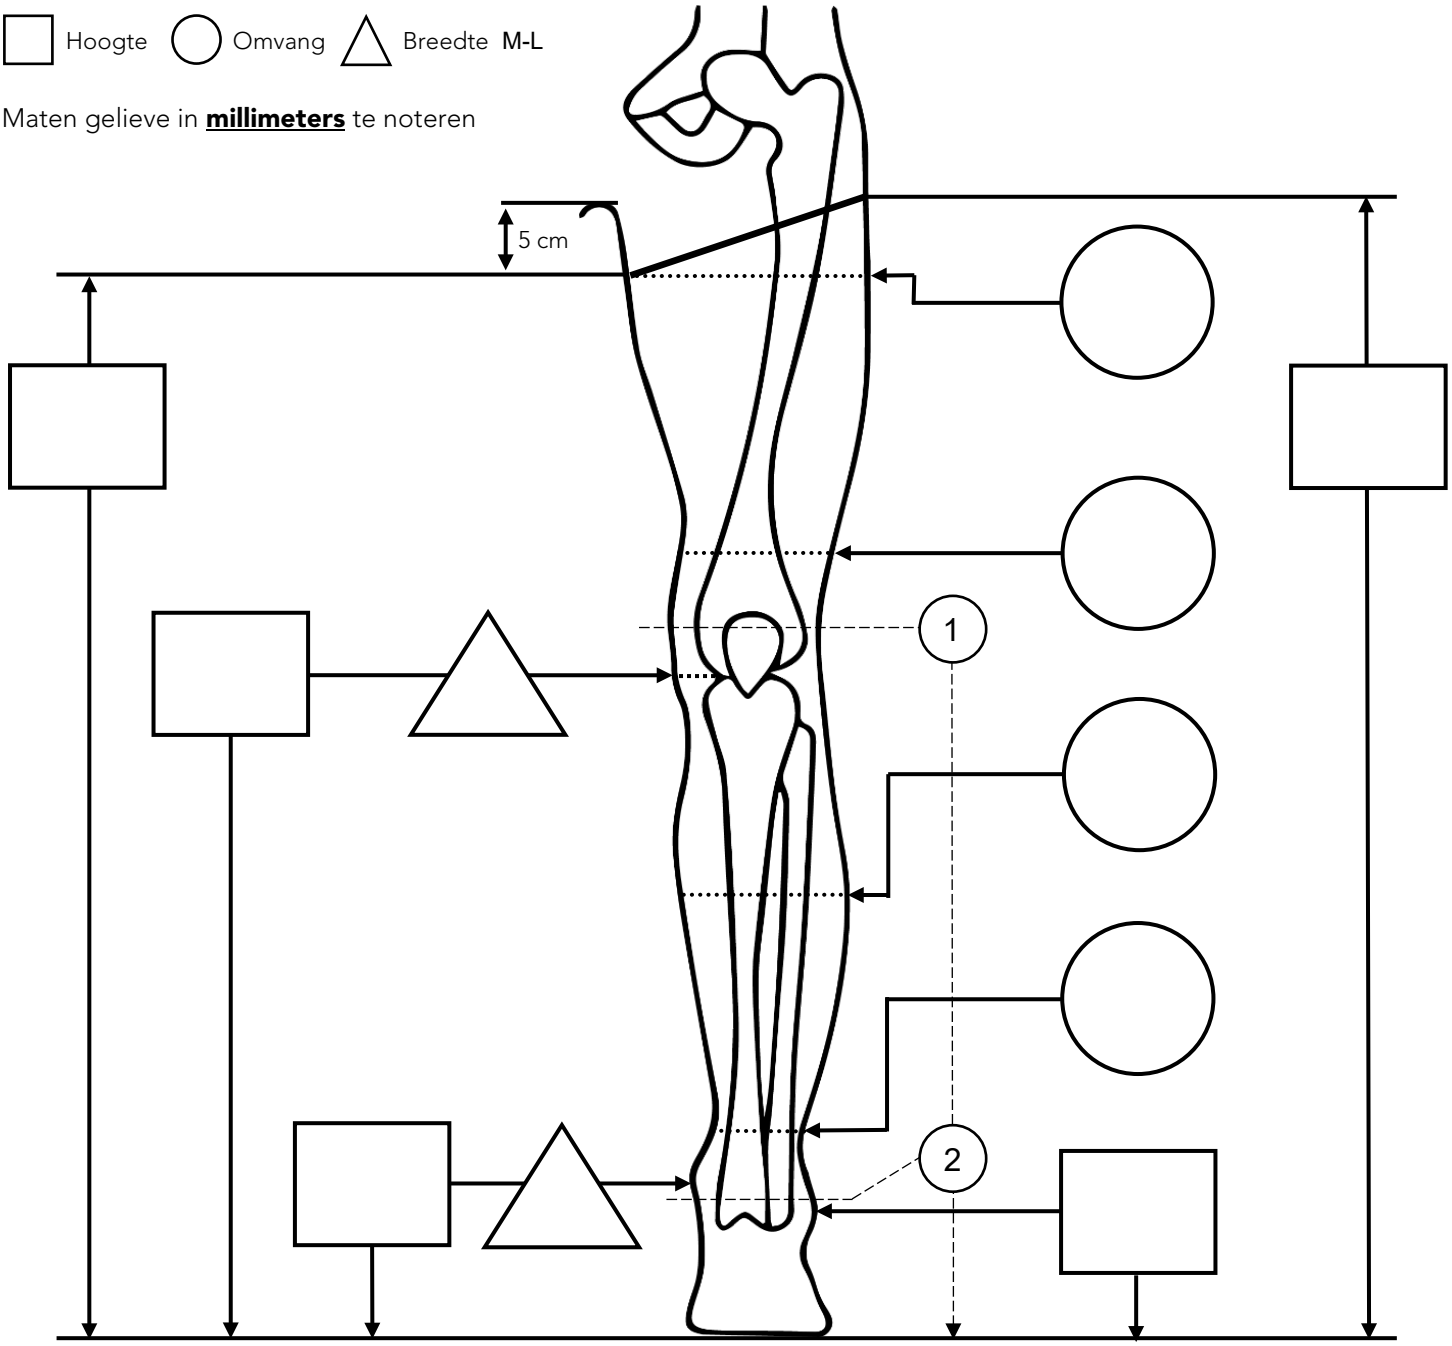

Mechanische as-hoogte orthese:

(1) Knie-as grond hoogte _____ mm

(2) Enkel-as grond hoogte _____ mm

Orthese configuratie

Uitvoering links:

- ❍ COS-SPL001-L (unilateraal)
- ❍ COS-SPL002-L (bilateraal)
- ❍ COS-SPL003-L (knie = bilateraal & enkel = unilateraal)

Uitvoering rechts:

- ❍ COS-SPL001-R (unilateraal)
- ❍ COS-SPL002-R (bilateraal)
- ❍ COS-SPL003-R (knie = bilateraal & enkel = unilateraal)

Model:

- ❍ COS-SPL A
- ❍ COS-SPL B
- ❍ Model volgens tekening op gips

Voering:

- ❍ Vast, 4 mm (kleur: grijs/ zwart)
- ❍ Uitneembaar, 3 mm (kleur: zwart)

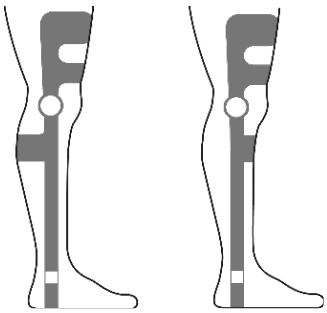

Model A Model B

_____ Datum

_____ Naam *(in blokletters a.u.b.)*

_____ Handtekening

Omtrek binnenzool schoen

Pat. ID-nummer: _____

Nb.: Samen met de gipsmaatname wordt geprobeerd de voetplaat zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de omtrek van de binnenzool van de schoen.
Het kan zijn dat achteraf kleine aanpassingen gedaan moeten worden om de pasvorm te optimaliseren.

Basko Health**care**

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail: verkoop@basko.com

basko.com

9901881 / Stand10/2022